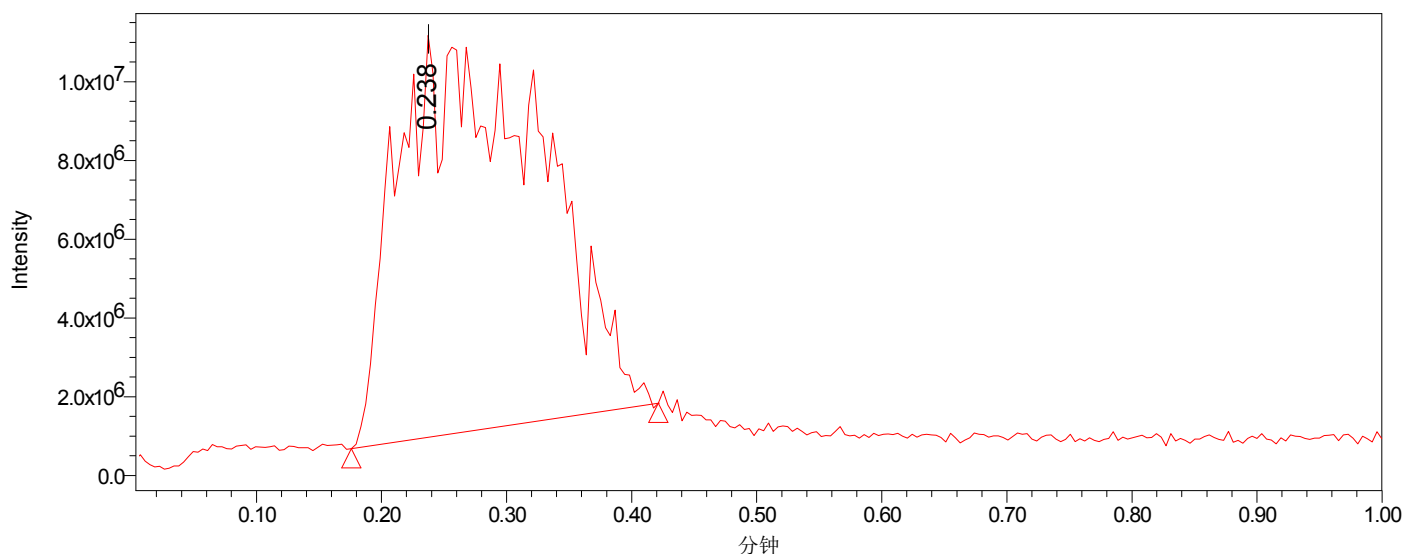


样品信息


样品名称:	2058-94-8	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	test20230911
样品瓶:	2	采集方法组:	1_ESI_MS_20%Water
进样次数:	1	处理方法:	2058_94_8
进样体积:	1.00 ul	通道名称:	MS TIC
运行时间:	1.0 Minutes	处理通道说明:	QDa 负 扫描 MS TIC (QDa 负(-))
采集时间:	2023/9/11 8:46:50 CST		
处理时间:	2023/9/11 9:09:47 CST		

自动缩放色谱图

峰结果
通道: QDa 负 扫描

0.238	79716684	9696245	QDa 负 扫描	100.00
-------	----------	---------	----------	--------

匹配图

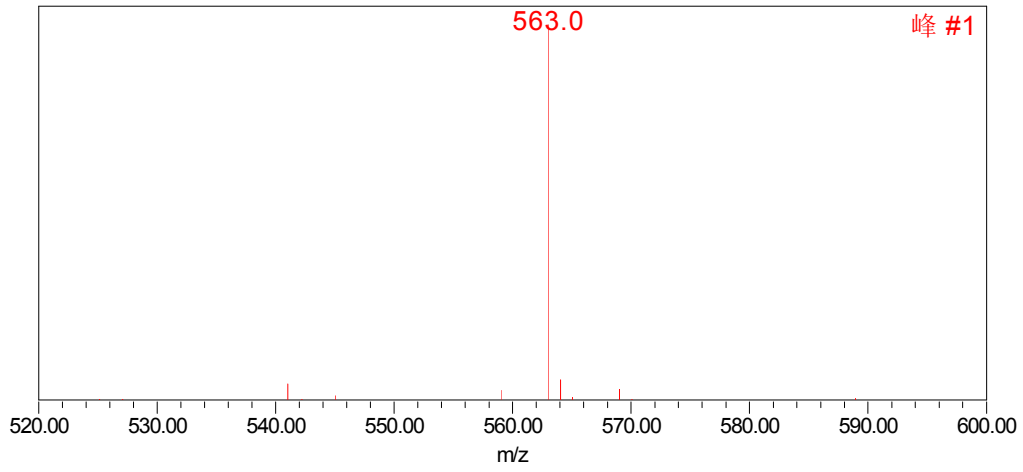

样品名称 2058-94-8 样品瓶 2 进样 1 采集日期 2023/9/11 8:46:50 CST MS 3D 通道 名 QDa 负 扫描